



Chris
LOEWERT
Graphiste
Chargé de com'

Chris est un **graphiste multidisciplinaire** et un **développeur web** basé à Strasbourg, France.

Créatif, passionné et fort de plus de **20 années d'expérience**, il est à la recherche d'un poste qui lui permettra de mettre ses acquis professionnels au profit d'une société dynamique, en contribuant à sa communication en B to C, en B to B et en interne.

- 1 ■ Compétences**
- 2 ■ Expériences**
- 3 ■ Logiciels couramment utilisés**
- 4 ■ Langues**
- 5 ■ Equipement**
- 6 ■ Centres d'intérêts**
- 7 ■ Contact**



Compétences

Compétences pratiques

- | Design graphique |
- | Illustration |
- | Photographie |
- | Web design |
- | Vidéo |
- | Conception de logos |
- | Conseil en communication |
- | Formation à la prise en main de logiciels |

Conceptualisation, création et réalisation

- | Plaquettes produits |
- | Plaquettes publicitaires |
- | Catalogues |
- | Notices produits |
- | Packaging |
- | Encarts publicitaires revues professionnelles |
- | Affiches |
- | Posters |

- | Stands salons professionnels |
- | Sites web |
- | Emailings |
- | Sourcing fournisseurs |

Compétences



ACCUEIL

TRAVAUX

ACT

“
Ce qui importe par-dessus tout dans une œuvre d'art, c'est la pr

James JOYCE

TRAVAUX D



SITES WEB
Développement & design
institutionnel & e-commerce

Le Savon d'Alep

Innovation, our Mission



Parasitology • Autoimmunity • Tumor markers • Virology • **OBSTETRICS** • Autoimmunity • Parasitology • Bacteriology • Autoimmunity • Parasitology

References

90009 :
of 10 tests
001 :
-1 positive control
3 :
e control

PREMAQUICK®

Triplex rapid test for prognosis of imminent birth

PREMAQUICK is a simple and rapid immunochromatographic test that allows **combined detection of 3** markers: native IGFBP-1 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1) total

Appearance of regular contractions before Gestational Age TPL. An



PLAQUETTES PRODUITS

Créa & suivi du print en B to B et en B to C



Bandelette

Indicateur : présence ou absence de bande Test colorée.

Indicateurs : bleu pour le facteur humaine et rouge animale.

Sensibilité (100%) et spécificité (96%) en test immuno-enzymatique quantitatif.

Volume 2 UI/ml parfaitement adapté au dépistage.

Temps coup par coup avec lecture en moins de 10 minutes.

Type qualitatif ou semi-quantitatif.

Pitch 3 références disponibles : 25 bandelettes IgG humaines,



coloration automatisée
à portée de main

processus de coloration des techniques les
acido-résistantes...

GRANDE CAPACITE

CHOIX DE REACTIFS



Portoir conçu pour une meilleure
productivité : 20 lames / série



Système de coloration automatisée
ouvert : tout réactif accepté

programmation guidée).
moins de 5 minutes
cycle de durée variable (selon réactifs utilisés)

chez la coloration sélectionnée.



Huile d'im

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MULTI STAINER® (REF 8040)

- Panier support | Capacité de 20 lames
- Module de coloration | 4 bacs de réactifs, a
1 bac de rinçage, a
1 chambre de séc
- Système de programmation | Réglage du tem
et du temps d
Mémoire
- Alimentation électrique | 220/230 V, 50/6
- Dimensions | L 70 x l 44 x h
- Poids | 25,5 Kg (poids

REACTIF

REACTIFS*

Colorant	
Mordants	Iodine
Décolorant	Différent
Contre-colorant	Safranine

REACTIFS* - COLORATIONS

Colorants	Auramine Phén Carbol Fuchs
Décolorants	Différent Différent
Contre-colorants	Rouge P
Huile d'im	



Naturam



DÉPOLLUTION DE L'EA


DÉPOLLUTION DES

CATALOGUES
Créa & suivi du print

PLAQUETTES & ENCARTS PUBLICITAIRES,
FLYERS, AFFICHES & POSTERS

Créa & suivi du print

algori

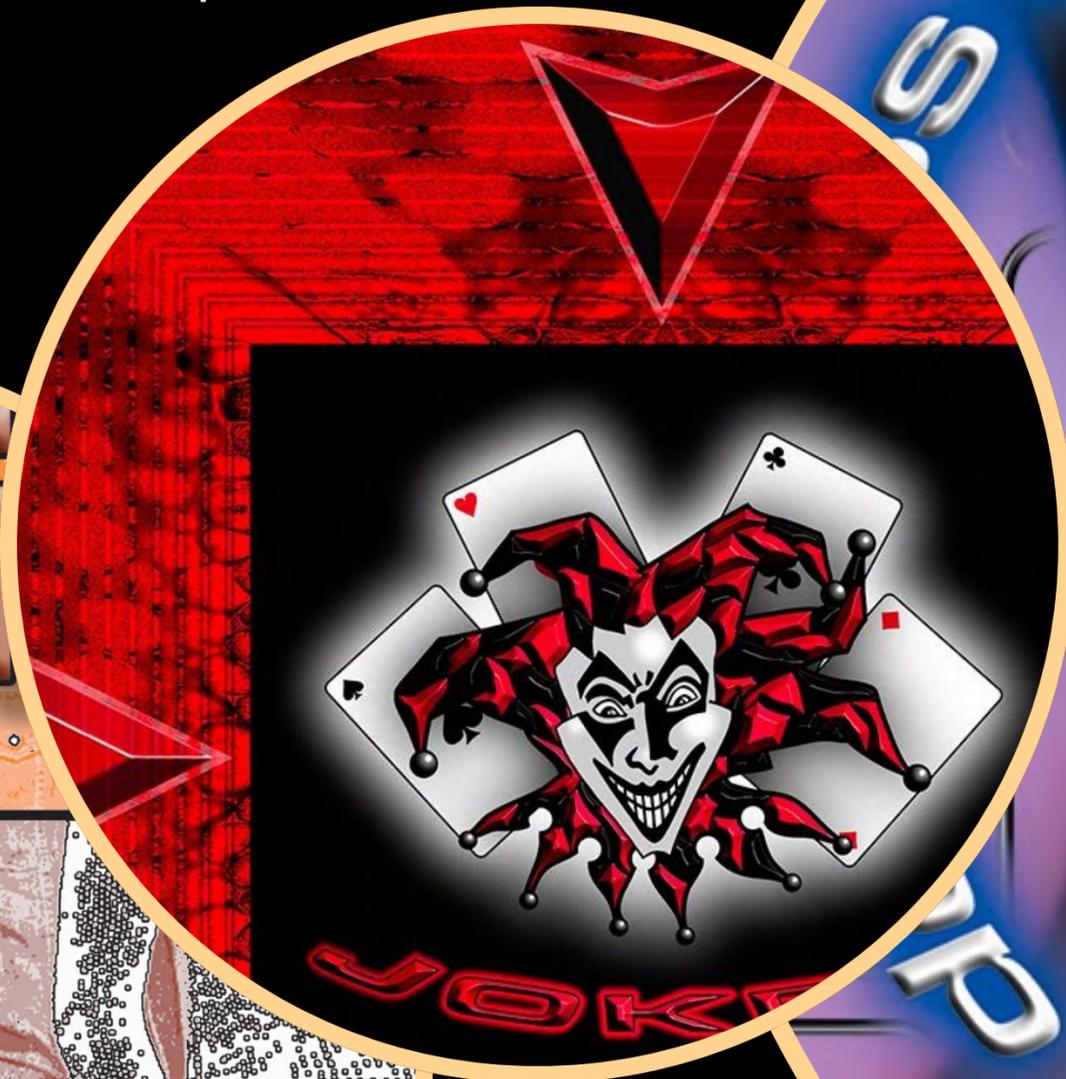




BRIN DE

AMNIO



LOGOTYPES

Créa, intégration, enseignes ...

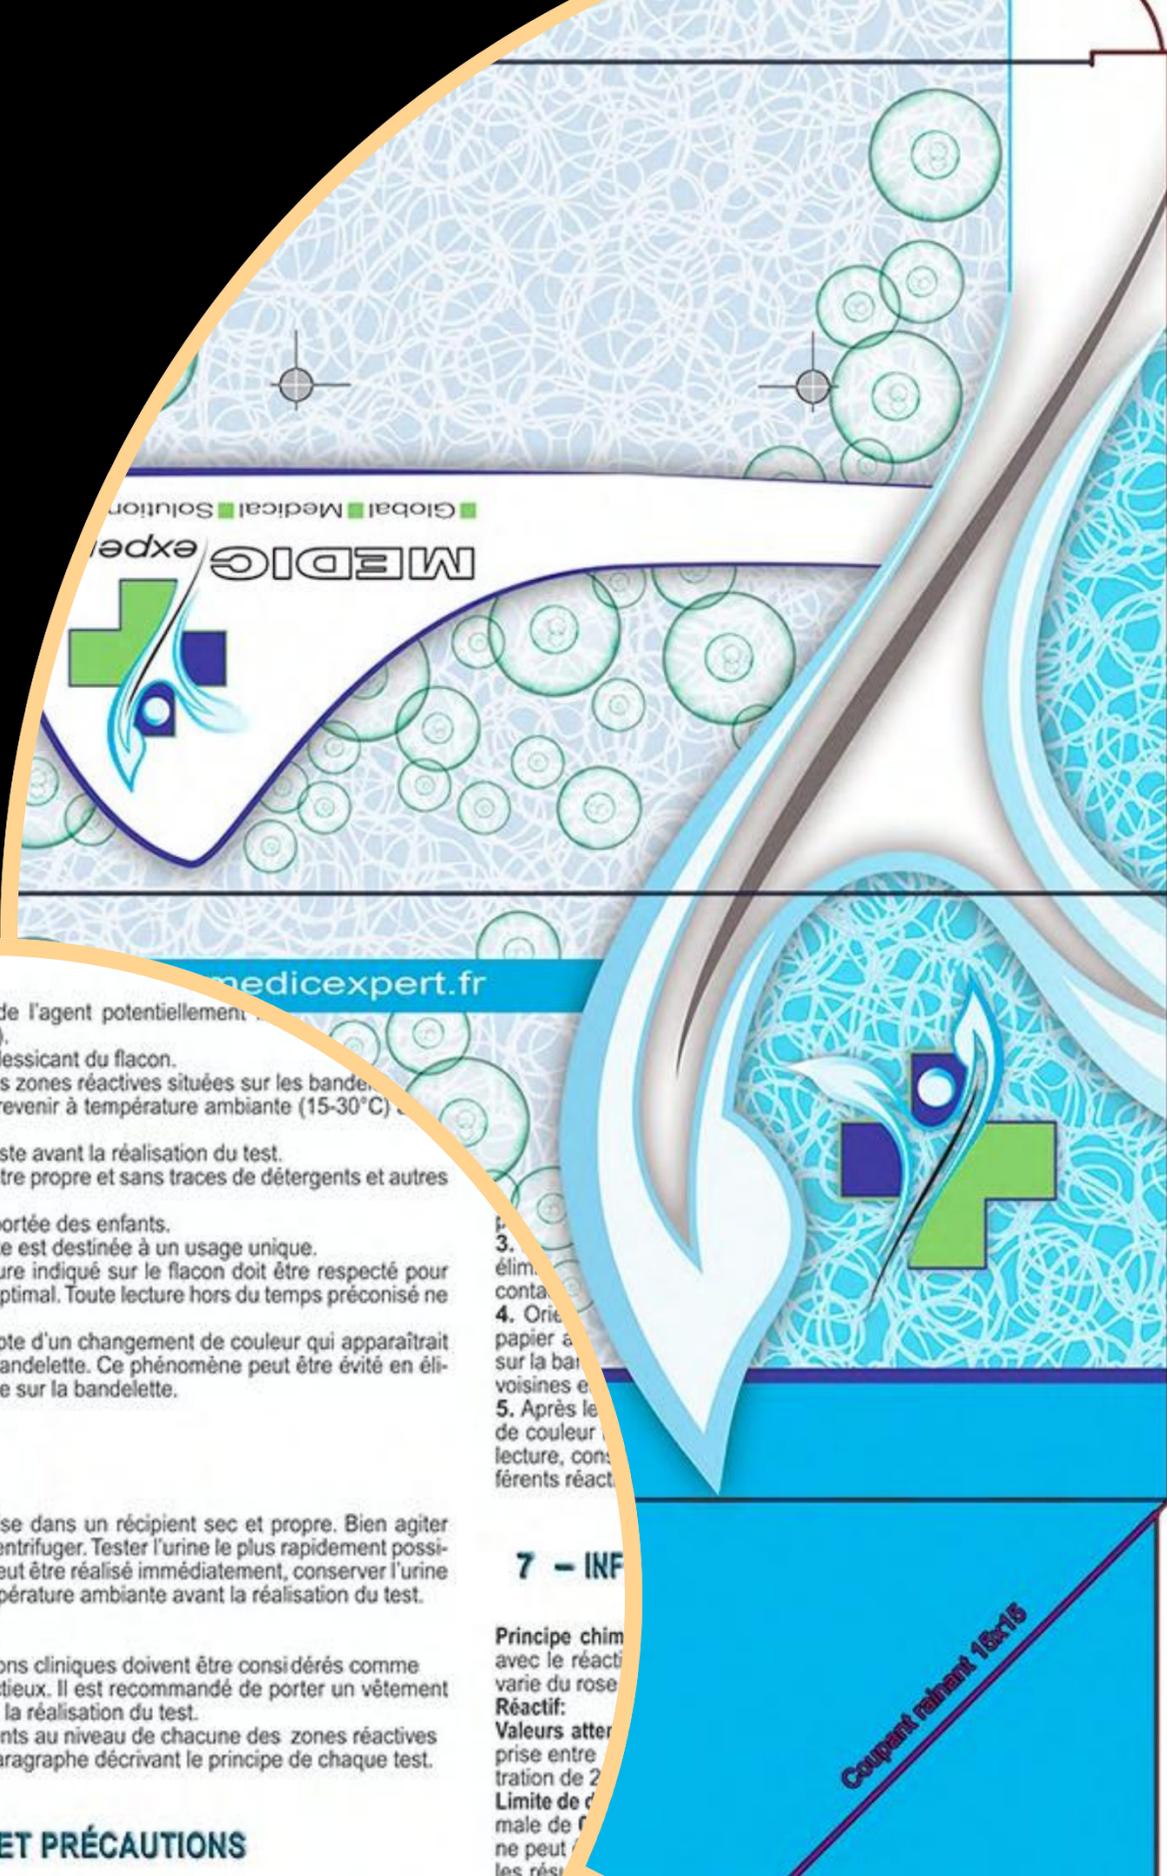

après suppression de l'agent potentiellement contaminant, vitamine, etc..).

- Ne pas retirer le dessiccant du flacon.
- Ne pas toucher les zones réactives situées sur les bandelettes.
- Laisser le flacon revenir à température ambiante (15-30°C) avant de réaliser le test.
- Ouvrir le flacon juste avant la réalisation du test.
- La paillasse doit être propre et sans traces de détergents et autres contaminants.
- Ne pas mettre à portée des enfants.
- Chaque bandelette est destinée à un usage unique.
- Le temps de lecture indiqué sur le flacon doit être respecté pour garantir un résultat optimal. Toute lecture hors du temps préconisé ne peut être validée.
- Ne pas tenir compte d'un changement de couleur qui apparaîtrait sur les côtés de la bandelette. Ce phénomène peut être évité en éliminant l'excès d'urine sur la bandelette.

3 - ÉCHANTILLON

Recueillir l'urine fraîchement émise dans un récipient sec et propre. Bien agiter avant de réaliser le test. Ne pas centrifuger. Tester l'urine le plus rapidement possible après le recueil. Si le test ne peut être réalisé immédiatement, conserver l'urine réfrigérée et laisser revenir à température ambiante avant la réalisation du test.

Précautions d'utilisation:

- Tous les échantillons cliniques doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Il est recommandé de porter un vêtement de protection lors de la réalisation du test.
- Les réactifs présents au niveau de chacune des zones réactives sont listés dans le paragraphe décrivant le principe de chaque test.

4 - MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

7 - INF

Principe chimique avec le réactif varie du rose au rouge.
Réactif:
Valeurs attendues:
 prise entre 2 et 20 mg/L.
 Limite de dosage: 100 mg/L.
 male de 100 mg/L.
 ne peut être utilisé.
 les résultats.

Coupage suivant 18x115

URITEC™
Bandelettes urinaires d'orientation clinique

elvetec services

URITEC™
Bandelettes urinaires d'orientation clinique

	228 936 URITEC™ 1	228 941 URITEC™ 2	228 957 URITEC™ 3	228 962 URITEC™ 4	228 978 URITEC™ 5	228 983 URITEC™ 7	228 989 URITEC™ 10
Glucose	•	•	•	•	•	•	•
Protéines	•	•	•	•	•	•	•
pH	•	•	•	•	•	•	•
Sang	•	•	•	•	•	•	•
Corps cétoniques	•	•	•	•	•	•	•
Nitrites	•	•	•	•	•	•	•
Densité (SG)	•	•	•	•	•	•	•
Leucocytes	•	•	•	•	•	•	•
Bilirubine	•	•	•	•	•	•	•
Urobilinogène	•	•	•	•	•	•	•

URITEC™
Bandelettes urinaires d'orientation clinique

elvetec services

PACKAGING & NOTICES
Créa & suivi fabrication



Expériences

Expériences

Chargé de communication

1995 - 2017

Secteur de la biologie médicale, en commerce B to B.
Formation d'adultes à la prise en main de logiciels.
En freelance (CL-digital).

Artiste peintre

1990 - aujourd'hui

Travaux présentés sur semaj.fr.

Styliste et designer dans la confection

1987 - 1990

Confection en prêt à porter et en sur-mesure.

Marques : Zingarella, Papagallo, Enoch Mc Bain,
Molambo, TurnOver.

En entreprise individuelle (CL-stylisme-design-
diffusion).



Logiciels couramment utilisés



| Suite graphique Adobe |

Photoshop, Illustrator, InDesign

| Suite graphique Affinity

Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Publisher

| Suite pour le développement web |

WordPress, Elementor, WooCommerce

| Suite vidéo Apple |

Final Cut, Motion

| Suite Office |

Word, Excel, PowerPoint

| Suite bureautique Apple |

Pages, Numbers, Keynote

| Notion.io |

Outil de productivité collaboratif, de gestion d'informations, de données, de projets ...

Blah Blah



Langues



Blah Blah

| **Allemand** | lu, écrit, parlé

| **Anglais** | lu, écrit, parlé

| **Italien** | notions



5

Equipement



| **Stations MAC Pro** |
| **Tablettes WACOM Cintiq** |
| **IPAD Pro** |
| **Reflex CANON EOS1** |
| **Compact SONY RX100** |
| **Caméra CANON XLH1** |

Ces équipements permettent d'envisager un poste en télétravail.



Centres d'intérêts



| **Arts** |

| **Peinture** |

| **Photographie** |

| **Sculpture** |

| **Editions** |

| **Design d'objets** |

| **Architecture** |



Contact

chris.loewert@gmail.com

STRASBOURG

+33 (0)6 83 88 09 15

FRANCE

A man with a grey beard and sunglasses is looking towards a vibrant, stylized mural. The mural features a large, smiling face with yellow and red accents, set against a background of green and blue. The man is wearing a dark grey shirt. The text "Get in touch." is overlaid in a bold, orange font, with a white horizontal line underneath it.

Get in touch.